
B300-Pro-M10产品安装使用指南

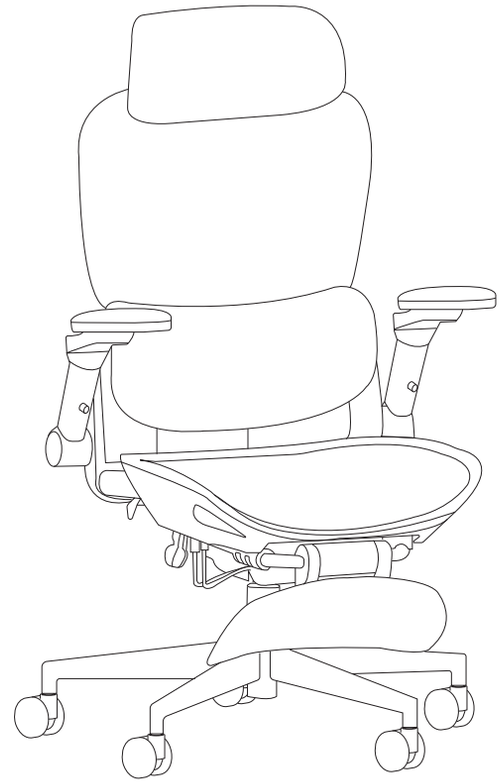

文件状态：管控文件


此页面为西昊内部审核使用，不作生产印刷，印刷请按此页之外的正规文件操作

制作：李嘉惠　　结构工程师：彭新宇　　工艺工程师：陈伟明　　审核：赵运丽　　核准：黄周胜

SIHOO

B300-Pro-M10

User Manual

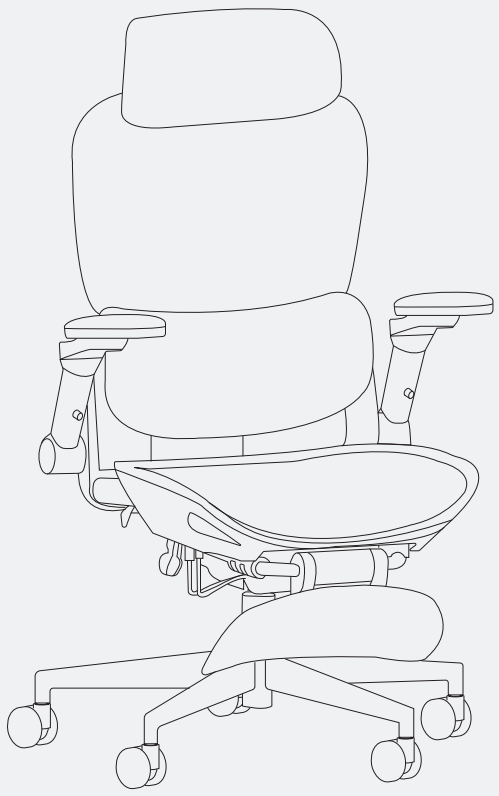

⚠

Do not allow children under the age of 5 to sit on the chair without supervision.

Kinder unter 5 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht auf dem Stuhl sitzen.

Non permettere ai bambini di età inferiore ai 5 anni di sedersi sulla sedia senza supervisione.

No permita que niños menores de 5 años se sienten en la silla sin supervisión.

Ne laissez pas les enfants de moins de 5 ans s'asseoir sur la chaise sans surveillance.

5歳未満のお子様が椅子を使用する場合は、保護者の監督のもとでご利用ください。

لا تسمح للأطفال دون سن الخامسة بالجلوس على الكرسي دون إشراف.

Produktinformationen & Mehr

Normen/ Zertifikate Qualitätsgütesiegel	Konstruktionsgrundlage der SIHOO Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die Sihoo Serie ist SGS + TÜV Rheinland LGA Produkts GmbH geprüft und zertifiziert.
EN Siegel	EN 1335 -1/-2: 2018 Büro-Arbeitsstuhl EN 16955: 2017 Gasdruckfeder / EN 12529 Laufrollen
Zertifikatssymbol	Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über EN hinaus
Garantie	Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Garantie
Wartung/Reinigung	Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (keine Mikrofaser). Zuerst reinigen, dann pflegen.
Anwendung	Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Anletung benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch(z.B. Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.
Rollen	Die Rollen sind für verschiedene Bodenarten geeignet.
Wichtiger Hinweis	Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenen Fachpersonal.
Vertretung in Europa: **MARWAY Consulting UG (haftungsbeschrankt)**	Am Maibusch 108 -110,45883, Gelsenkirchen, Germany Tel: 0049 17645084650 Email: MARWAY.UG@outlook.com
Representative in England: **GSG CONSULTING GROUP LIMITED**	Address: Montague Houses, Unit 3, Matthew Street, Manchester Postcode: M12 5BB Tel: +44 7850 387628 Email: GSG-GROUP@outlook.com

Einstellen der Kopfstütze
Die Kopfstütze lässt sich um 11 cm in der Höhe verstellen und an zwei Gelenken drehen: eines ermöglicht eine Drehung um 45°, das andere um 25°.

Einstellen der Rückenlehnenneigung (110°, 123°, 135°)
Ziehen Sie den Griff unter dem Sitzkissen heraus, um die Neigefunktion zu entriegeln. Schieben Sie den Griff wieder hinein, um die Rückenlehne in einem der drei verfügbaren Winkel (110°, 123° oder 135°) zu arretieren.

Einstellen der Rückenlehnenhöhe
Fassen Sie die Rückenlehne und ziehen Sie sie nach oben, um die Höhe um bis zu 6 cm zu verstellen.

Einstellen der Lendenstütze
Die Lendenstütze lässt sich 2,5 cm vor- und zurück sowie 5 cm auf- und ab verstellen.

Einstellen der Armlehnen
Die Basis der Armlehnen lässt sich 4,5 cm in der Höhe verstellen und um 60° nach innen bzw. außen schwenken. Die Armauflagen lassen sich 3,8 cm vor- und zurückschieben, sich um 360° drehen und um 40° nach oben neigen.

Einstellen des Sitzkissens
Drehen Sie den Hebel unter dem Sitzkissen, um die Sitzhöhe von 46,8 bis 55,3 cm zu verstellen. Ziehen Sie den Hebel an der Rückseite des Sitzkissens nach oben, um die Sitztiefe von 42 bis 47 cm einzustellen.

Einstellen des Neigungswiderstands
Verwenden Sie den Drehknopf unter dem Sitzkissen, um den Neigungswiderstand an Ihr Gewicht anzupassen und ein leichtes, ausgewogenes Zurücklehnen zu ermöglichen.


Einstellen der Fußstütze (falls vorhanden)
Ziehen Sie die Fußstütze heraus, halten Sie die Verriegelung gedrückt, um sie zu entriegeln, und klappen Sie sie zum Gebrauch nach oben.

⚠ Gasdruckfeder – Sicherheitshinweis
Die Gasdruckfeder kann von Personen ohne professionelle Erfahrung eingebaut werden.
Wichtig: Jegliche Arbeiten an der Gasdruckfeder, einschließlich eines Austauschs, sollten nur von qualifi ziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Maintenance Suggestion
1. Clean this product gently with a damp cloth.
2. Retighten all screws once every six months.

Proper use of the chair is for single person seating only. The chair is not to be used for standing purposes and will not function as a stool or step-ladder. Use on even surfaces only. Improper use of this product or failure to use as directed may result in injury.

This chair is suitable for various types of flooring.

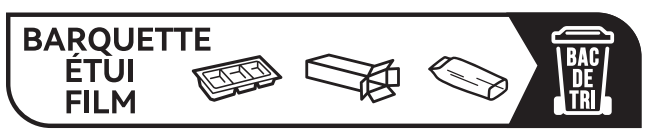

Séparez les éléments avant de trier



https://quefairedemesdechets.fr

CAUTION !
Work on gas springs only by trained specialist personnel.

ACHTUNG !
Arbeiten an Gasfedern nur durch eingewiesenes Fachpersonal.

B300-Pro-M10 Parts List

A x5

B x5

C D x1

E x1

F x1

G x1

H x1

I x1

J x1

K x1

L x2

M 5mm x1

N 5mm x1

O 4mm x2

P M6*12mm x2

Q M6*20mm x15

R 8mm x4

S M8*20mm x4

T M8*20mm x3

U M6*35mm x2


OR

V x1


W x2

Assembly Guide


01

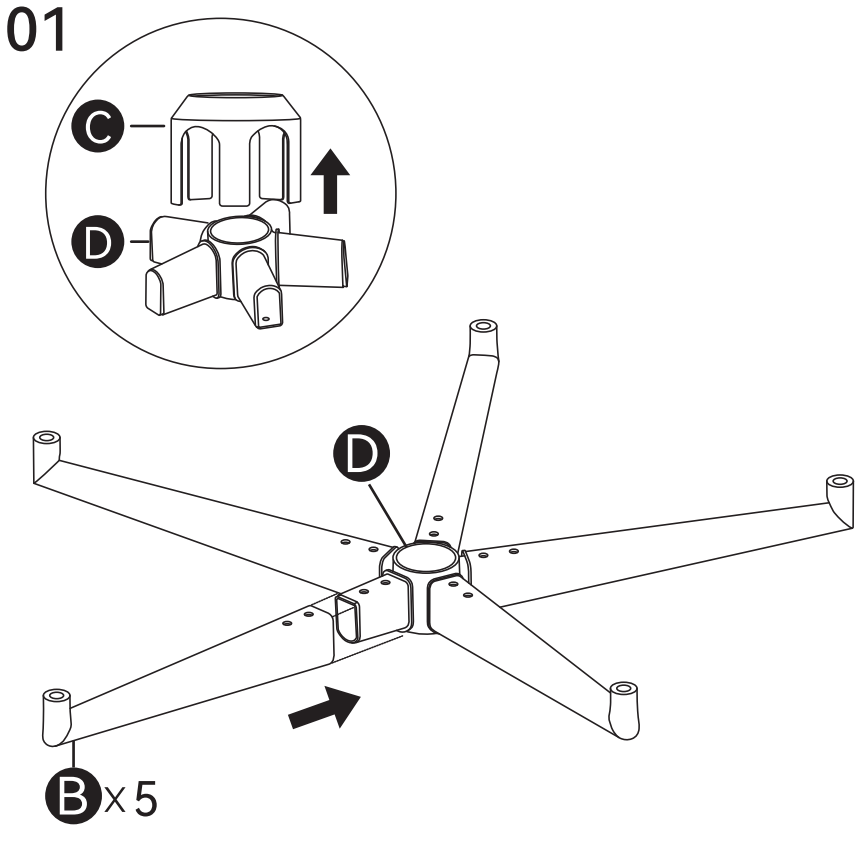


02

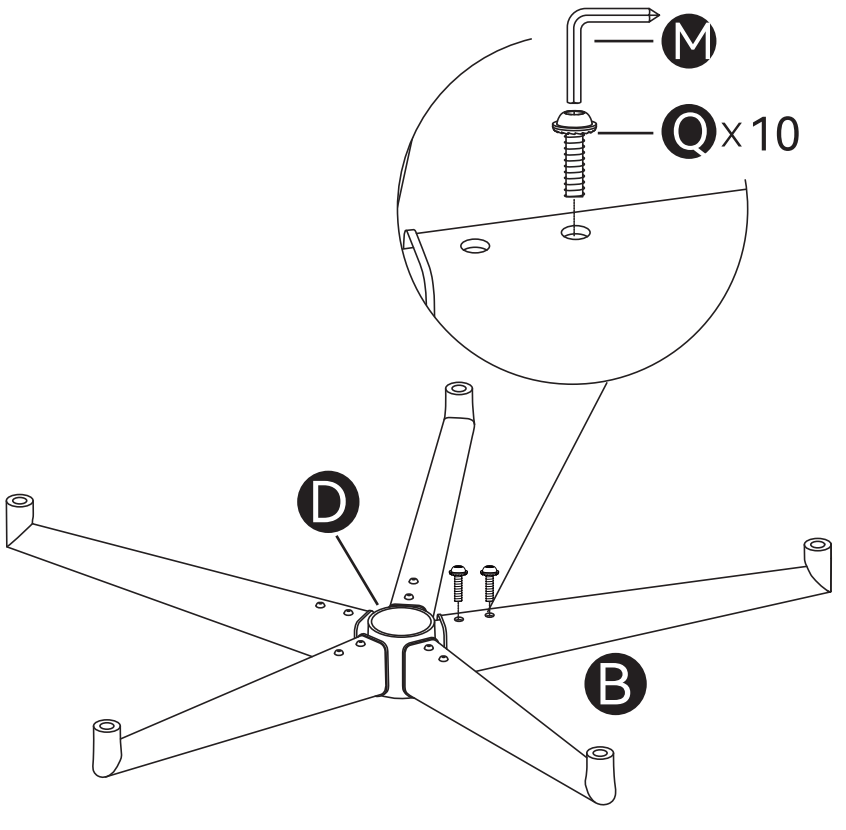


03

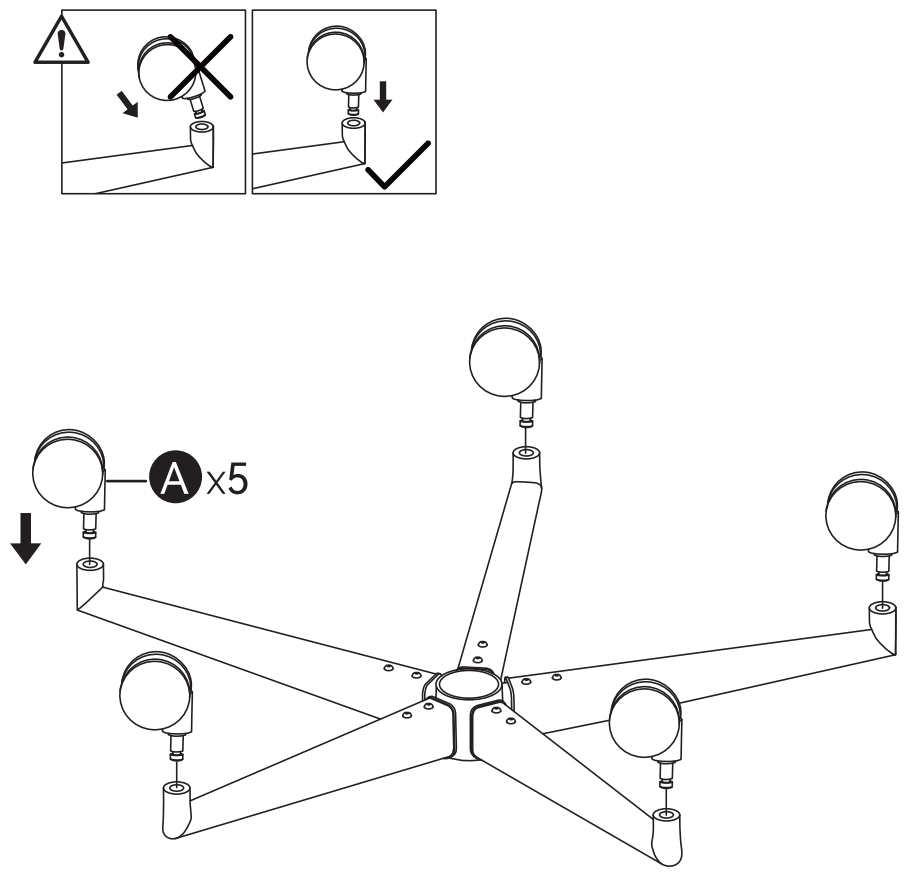


04

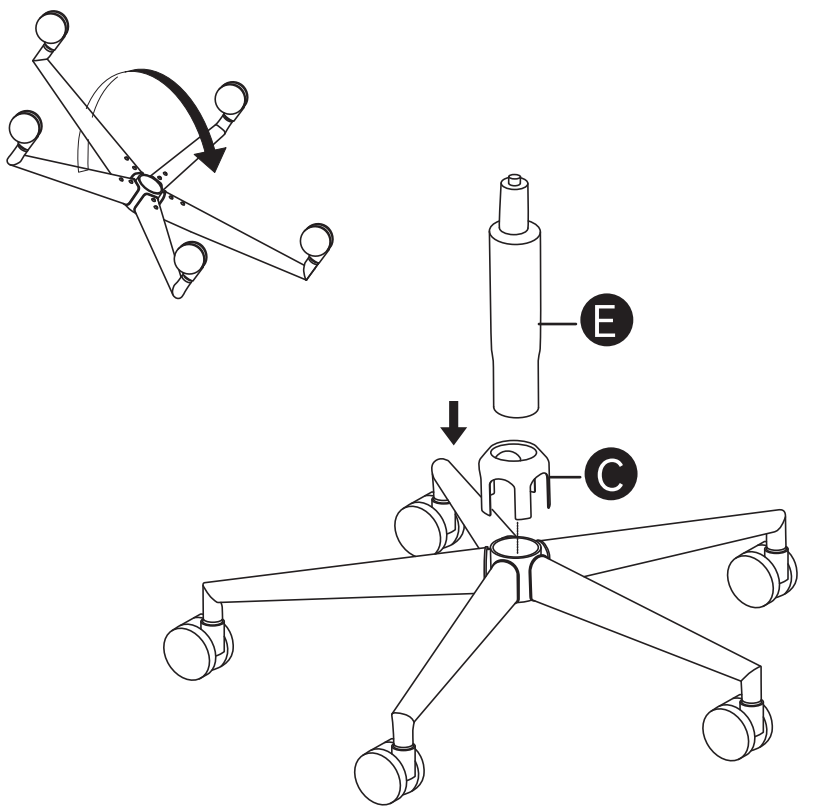


05

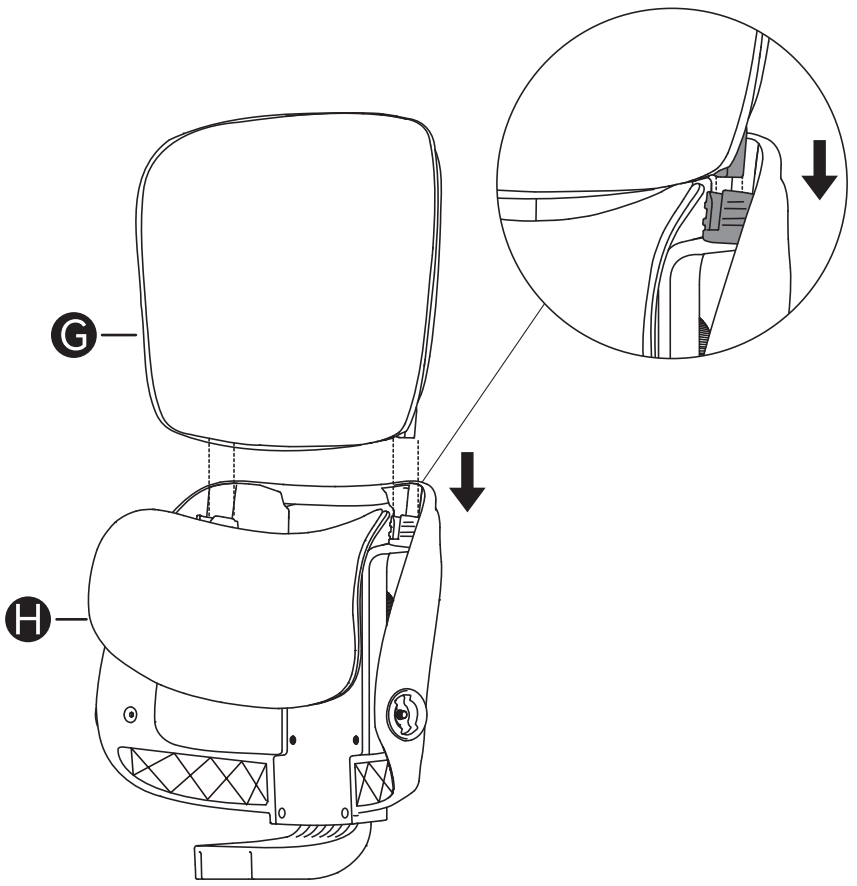


06

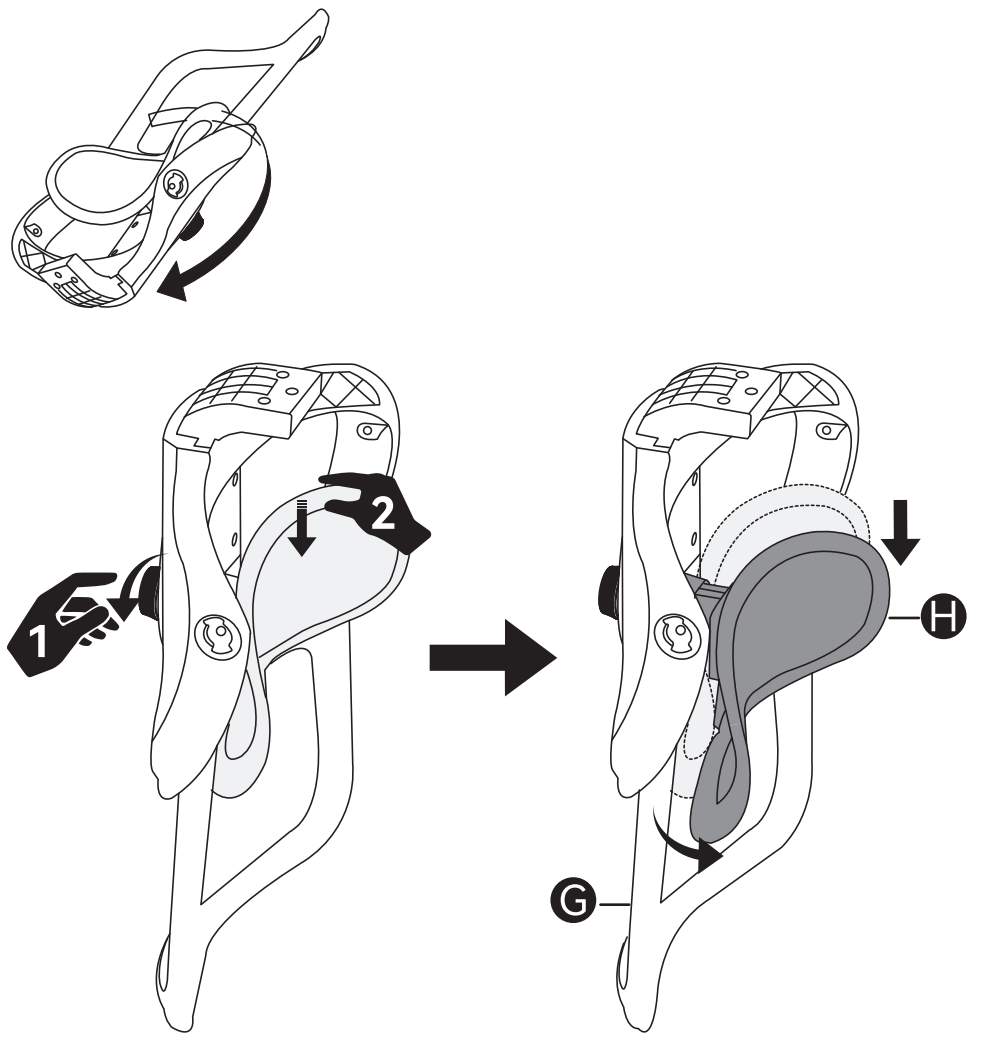


07

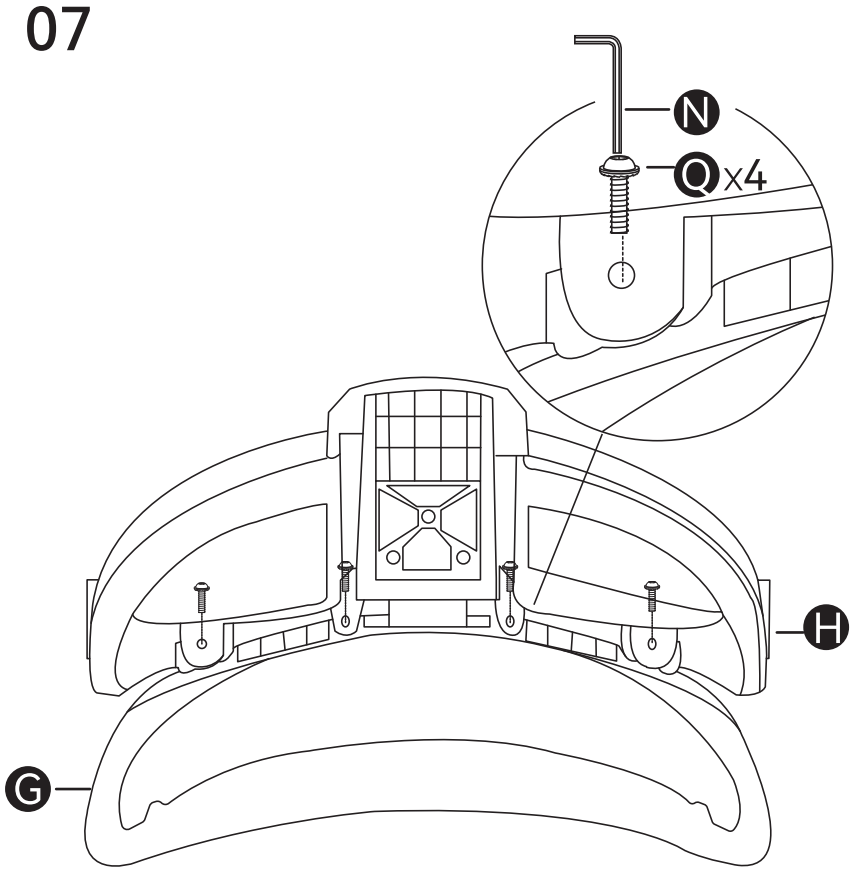



08

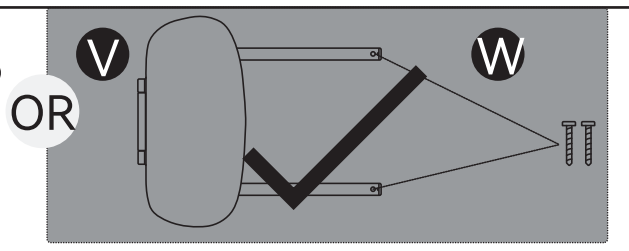

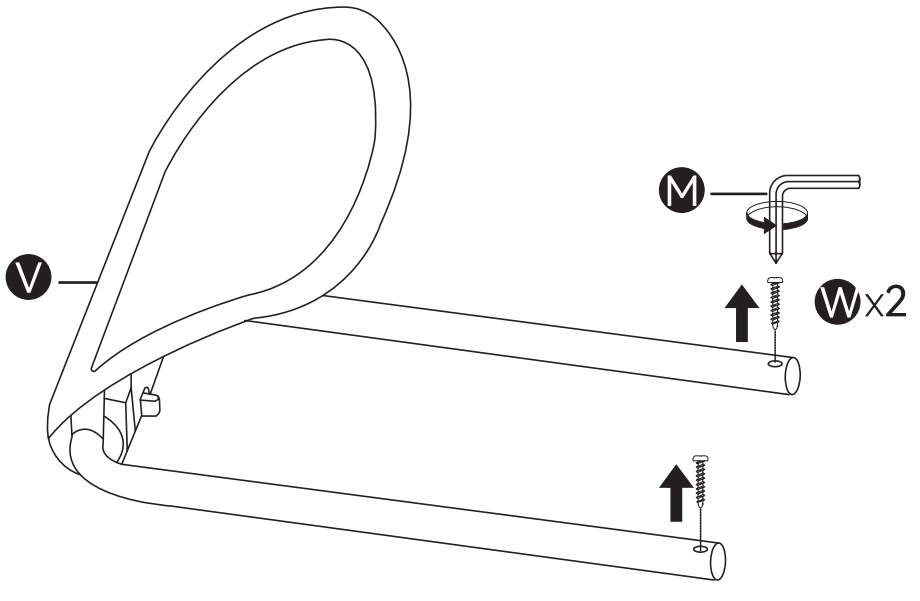


09

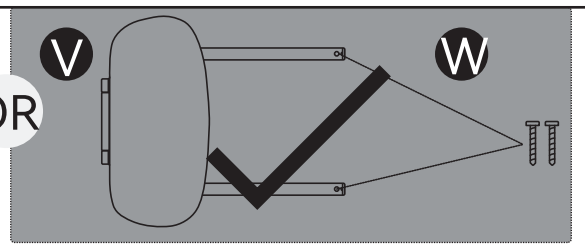


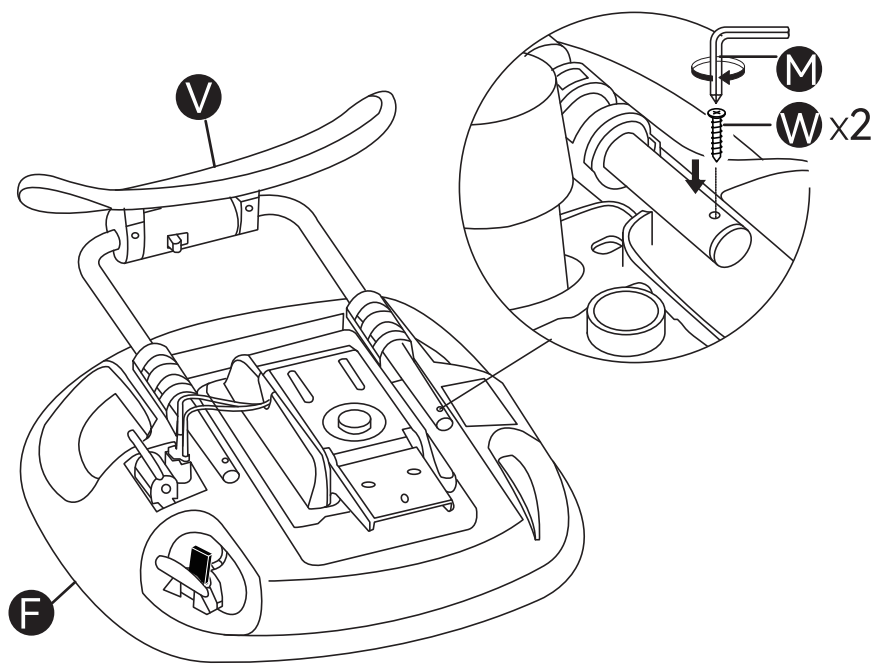


10

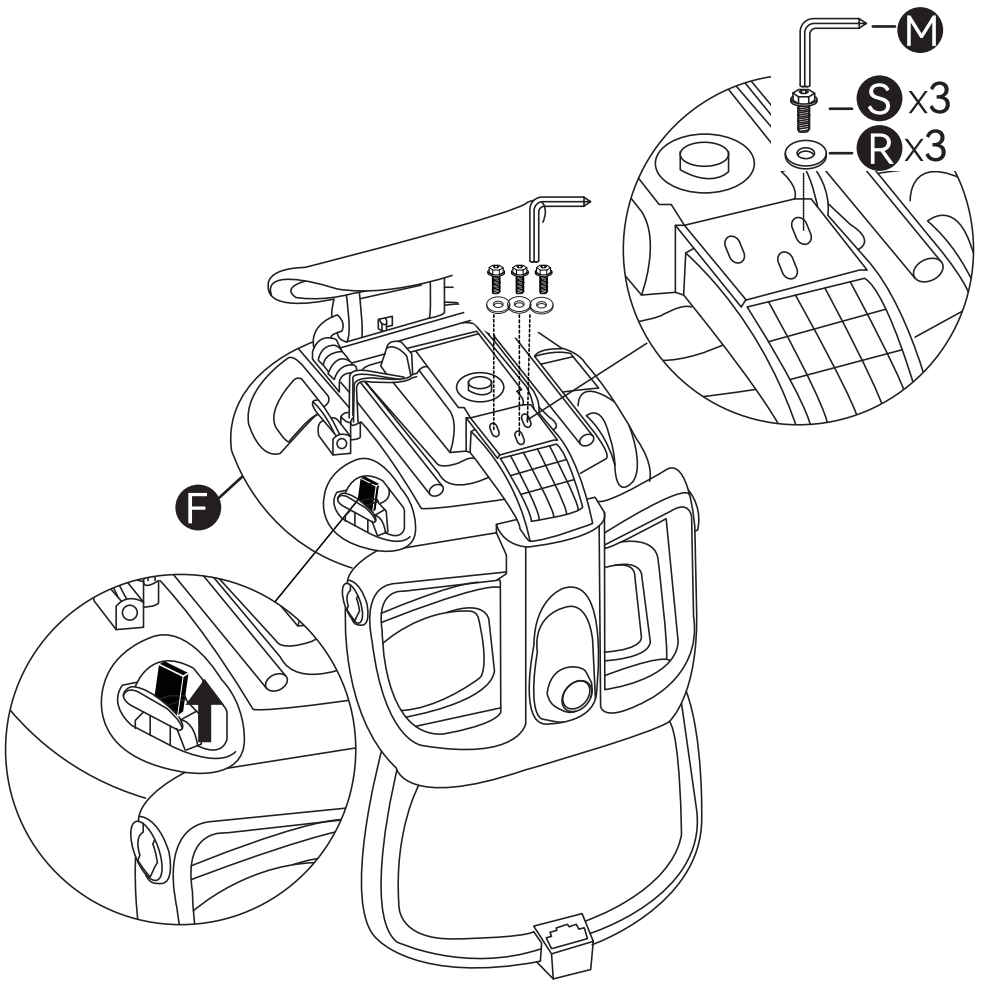


11

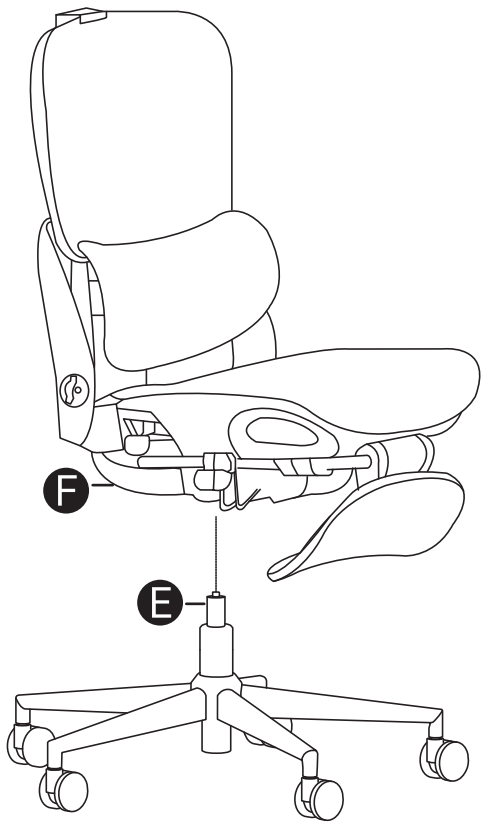


12

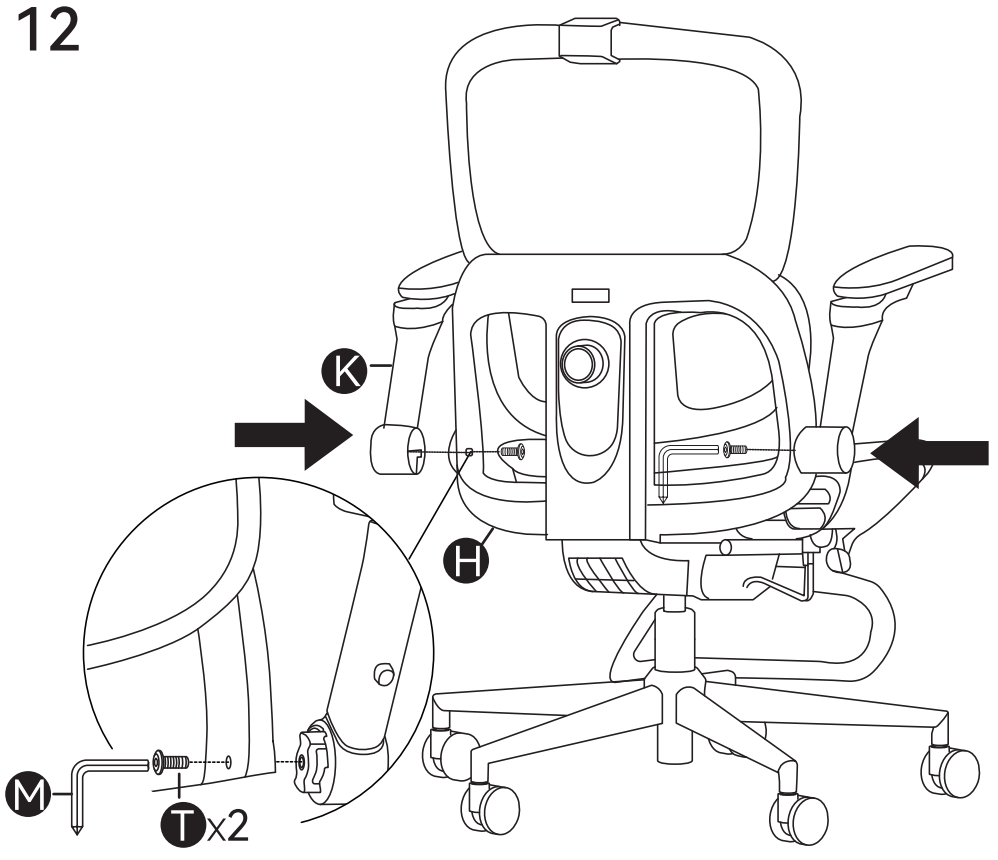


13

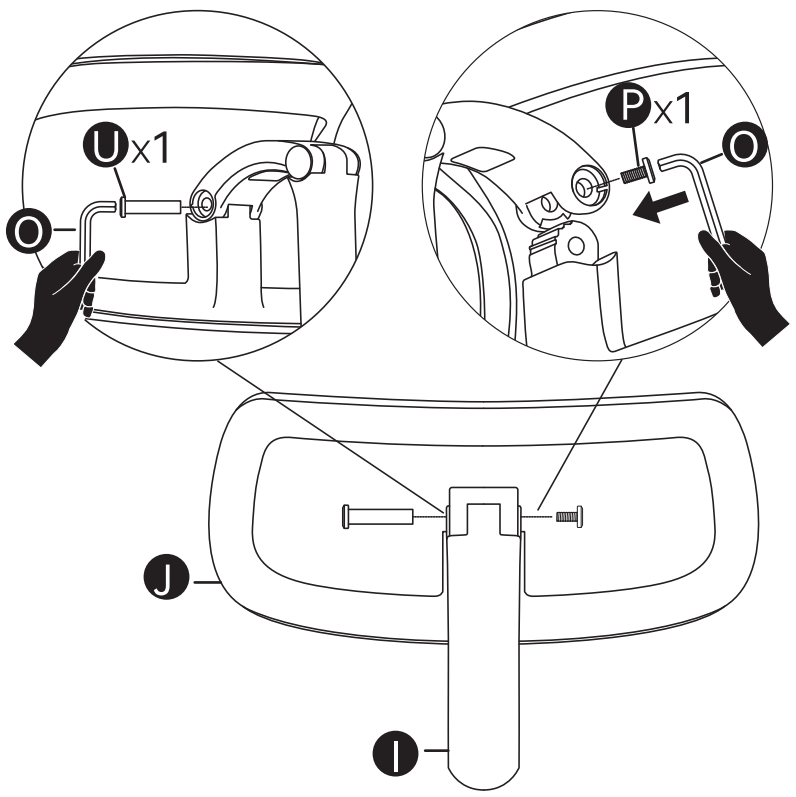

14

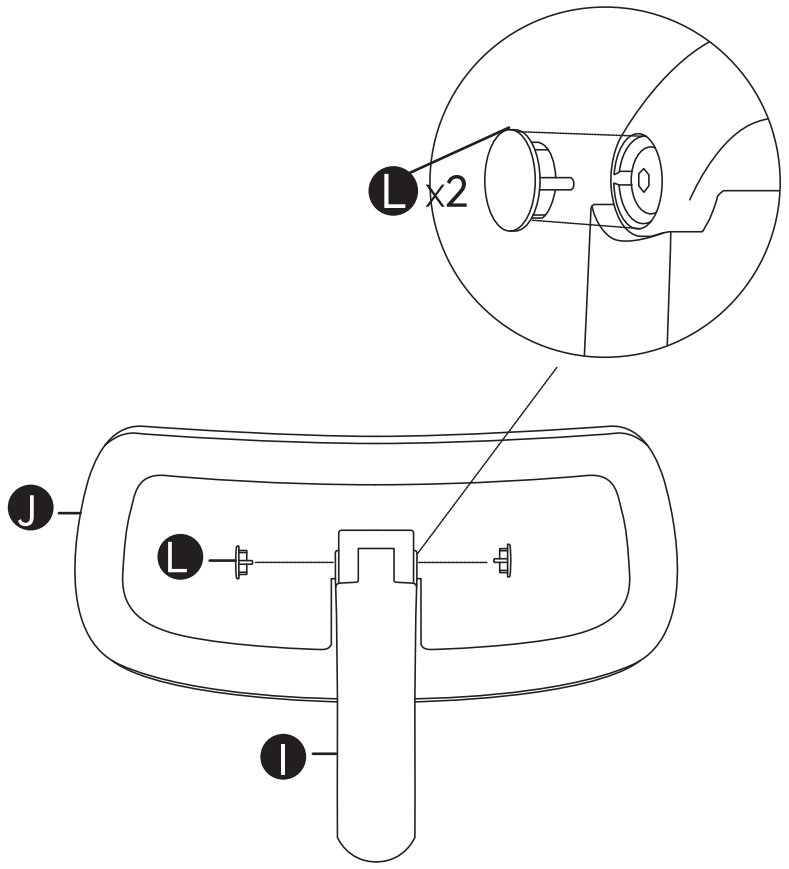

15

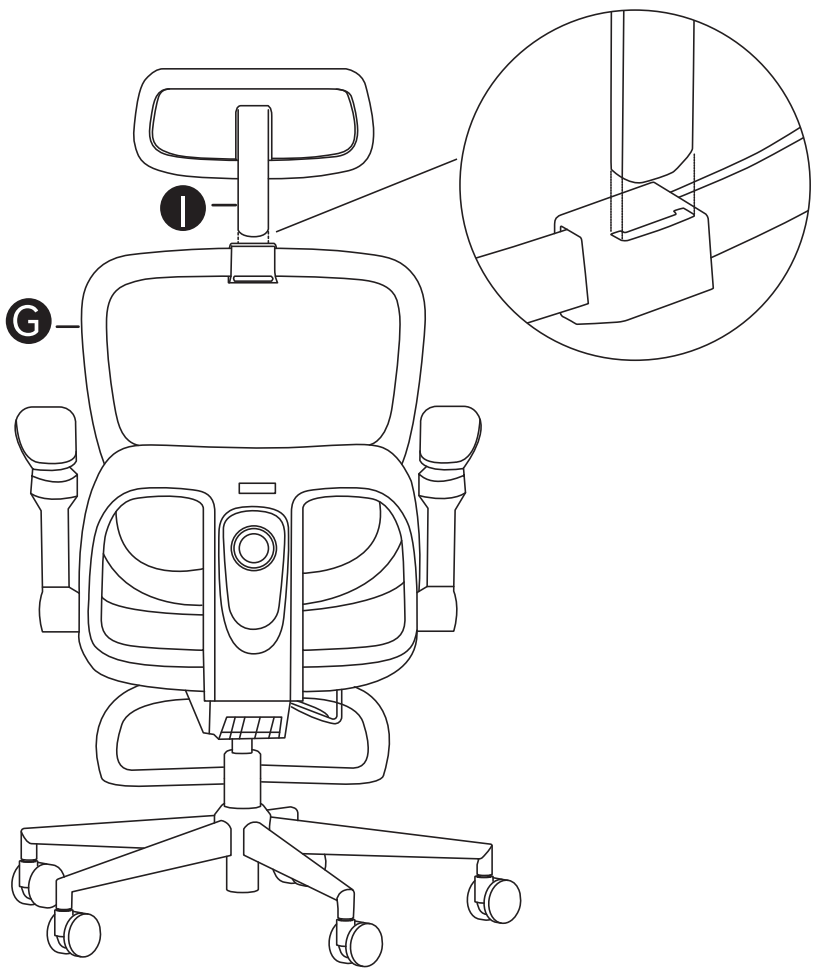

16

